

DEMANDE DE REPARATION – ENDOSCOPE SOUPLE

A joindre dans la valise avant envoi

Etablissement : _____
Contact : _____
Email : _____

Date : _____
Modèle : _____
N° de série : _____

L'endoscope est-il désinfecté ?


(Si non, merci d'utiliser le film de protection)

Oui Non

Fuite(s) :

(Marquez l'endroit d'une croix)

Oui Non

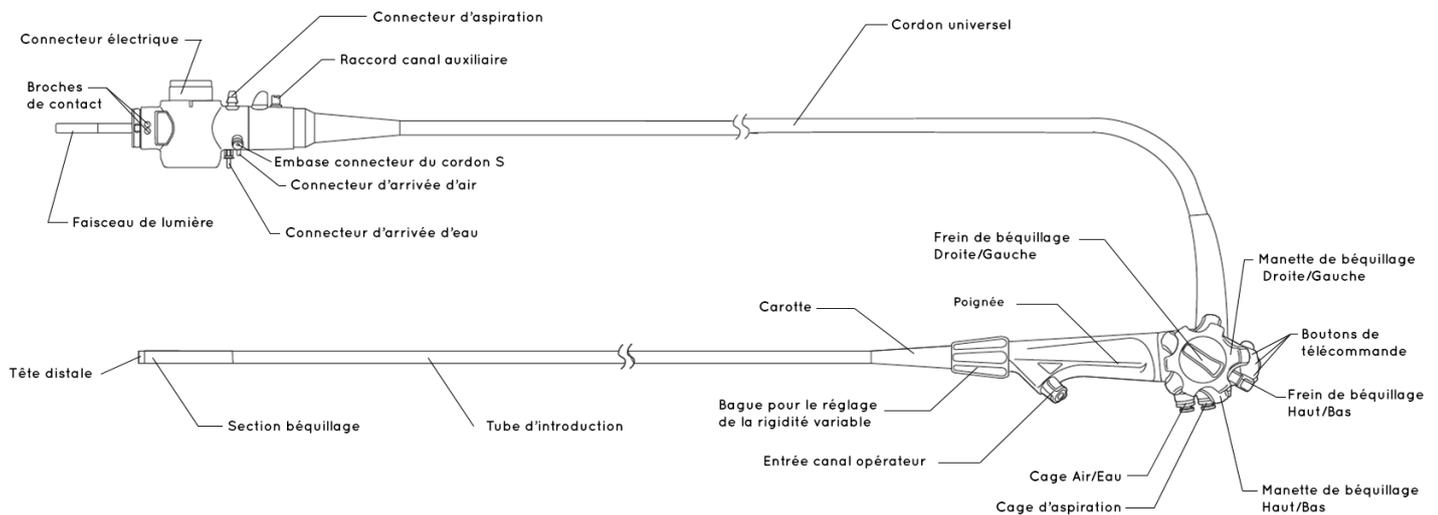

Listes des anomalies constatées : (marquez l'endroit d'une croix)

Système optique

- Faisceau lumière
- Perte image
- Image floue
- Réglage du focus défectueux

Canaux

- Canal opérateur
- Insufflation bouchée
- Aspiration défectueuse
- Valves endommagées

Gaine d'introduction

- Tête distale
- Gaine distale
- Tube d'introduction

Connecteur

- Cordon universel
- Connecteur

Poignée

- Boutons de télécommande
- Béquillage défectueux
- Dureté dans le béquillage
- Jeu au niveau du béquillage

Informations complémentaires :

