

## DEMANDE DE REPARATION – ENDOSCOPE SOUPLE

A joindre dans la valise avant envoi

Etablissement : \_\_\_\_\_  
Contact : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_

Marque : \_\_\_\_\_  
Modèle : \_\_\_\_\_  
N° de série : \_\_\_\_\_

### L'endoscope est-il désinfecté ?


(Si non, merci d'utiliser le film de protection)

Oui  Non

### Fuite(s) :

(Marquez l'endroit d'une croix)

Oui  Non

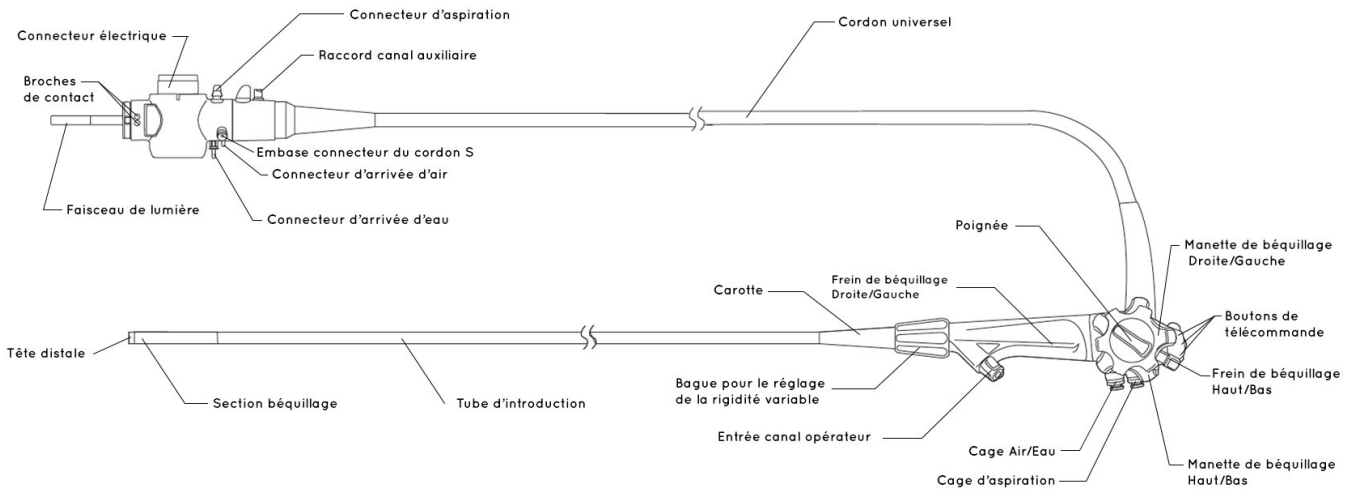

### Listes des anomalies constatées : (marquez l'endroit d'une croix)

#### Système optique

- Faisceau lumière
- Perte image
- Image floue
- Réglage du focus défectueux

#### Canaux

- Canal opérateur
- Insufflation bouchée
- Aspiration défectueuse
- Valves endommagées

#### Gaine d'introduction

- Tête distale endommagée
- Gaine distale
- Tube d'introduction

#### Connecteur

- Cordon universel endommagé
- Connecteur endommagé

#### Poignée

- Boutons de télécommande
- Béquillage défectueux
- Dureté dans le béquillage
- Jeu au niveau du béquillage

### Informations complémentaires :

---



---



---